Information

Die nachfolgenden Angaben geben lediglich die Systemanforderungen an Rechnersysteme wieder. Der ordnungsgemäße Betrieb der DÜRR MEDICAL Hard-/Software kann auch bei Einhaltung der Systemanforderungen durch spezifische Hardware- und Softwarebesonderheiten auf Kundenseite gestört werden. DÜRR MEDICAL übernimmt in diesen Fällen keine Gewähr für den störungsfreien Betrieb der DÜRR MEDICAL Hard-/Software.

Werden weitere Systeme an den PC angeschlossen, können sich die Systemanforderungen verändern. Die Systemanforderungen aller angeschlossenen Systeme beachten.

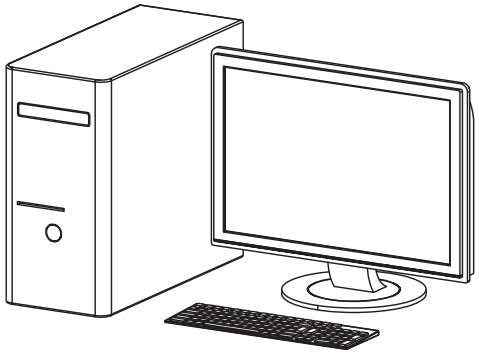

Speicherfolienscanner

Grundsätzlich gelten beim Betrieb des Gerätes die Systemanforderungen der jeweiligen Software, mit der das Gerät betrieben wird.
Es wird empfohlen, die aktuelle Version der Software zu verwenden.
Wird das Gerät mit Fremdsoftware betrieben, Systemanforderungen der Fremdsoftware beachten.
Zusätzlich müssen folgende Systemanforderungen beachtet werden:

CR 7 VET

Schnittstelle:	USB 2.0 USB 3.0 Ethernet ≥100 MBit/s
Maximale Kabelgesamtlängen:	USB: bis zu 5 m mit USB-Verlängerungskabel USB: bis zu 20 m mit zusätzlichem USB-Repeater / aktivem USB-Hub (je max. 5 m) - Details auf Anfrage
Software:	Vet-Exam Pro ab Version 1.0 Vet-Exam Pro Connect ab Version 1.2 Vet-Exam plus ab Version 7

CR 8 VET

Schnittstelle:	USB 2.0 USB 3.0 Ethernet ≥ 100 MBit/s WLAN IEEE 802.11b/g mit Verschlüsselung WPA und WPA2
Grafikkarte:	Auflösung ≥ 1024 X 768 Farbtiefe 32 Bit, 16,7 Millionen Farben
Software:	Vet-Exam Pro ab Version 1.0 Vet-Exam Pro Connect ab Version 1.2

CR 35 VETwin

Schnittstelle:	Ethernet ≥ 100 MBit/s WLAN IEEE 802.11b/g mit Verschlüsselung WPA und WPA2
Software:	Vet-Exam Pro ab Version 1.0 Vet-Exam Pro Connect ab Version 1.2 Vet-Exam plus ab Version 7

DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Division DÜRR MEDICAL
Höpfigheimer Str. 22
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
www.duerr-medical.de

9000-608-100/01

2204V003

Kleinröntgensysteme

Grundsätzlich gelten beim Betrieb des Gerätes die Systemanforderungen der jeweiligen Software, mit der das Gerät betrieben wird.
Es wird empfohlen, die aktuelle Version der Software zu verwenden.
Wird das Gerät mit Fremdsoftware betrieben, Systemanforderungen der Fremdsoftware beachten.
Zusätzlich müssen folgende Systemanforderungen beachtet werden:

VistaRay 7

Schnittstelle:	USB 2.0 USB 3.0
Maximale Kabelgesamt-längen:	USB: 5 m
Software:	Vet-Exam Pro ab Version 1.0 Vet-Exam Pro Connect ab Version 1.2 Vet-Exam plus ab Version 7

Intraorale Kamerasysteme

Grundsätzlich gelten beim Betrieb des Gerätes die Systemanforderungen der jeweiligen Software, mit der das Gerät betrieben wird.
Es wird empfohlen, die aktuelle Version der Software zu verwenden.
Wird das Gerät mit Fremdsoftware betrieben, Systemanforderungen der Fremdsoftware beachten.
Zusätzlich müssen folgende Systemanforderungen beachtet werden:

VistaCam iX HD Smart

Schnittstelle:	USB 2.0 USB 3.0
Maximale Kabelgesamt-längen:	bis zu 5 m mit USB-Verlängerungskabel bis zu 20 m mit zusätzlichem USB-Repeater / aktivem USB-Hub (je max. 5 m) - Details auf Anfrage
Software:	Vet-Exam Pro ab Version 1.0 Vet-Exam Pro Connect ab Version 1.2

VistaCam iX

Schnittstelle:	USB 2.0 USB 3.0
Maximale Kabelgesamt-längen:	bis zu 5 m mit USB-Verlängerungskabel bis zu 20 m mit zusätzlichem USB-Repeater / aktivem USB-Hub (je max. 5 m) - Details auf Anfrage
Software:	Vet-Exam Pro ab Version 1.0 Vet-Exam Pro Connect ab Version 1.2

Software

Vet-Exam Pro

gültig ab Version 1.2

CPU:	≥ Intel Core i3
RAM:	≥ 4 GB
Betriebssysteme:	64-bit-Betriebssystem: Microsoft Windows 10 (ab Pro) Microsoft Windows 11 (ab Pro) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022
Festplatte:	Workstation (ohne Datenbank) ≥ 50 GB Der Speicherbedarf der Datenbank orientiert sich am Bildaufkommen in der Praxis. (Kamerabild: ca. 1 MB, Röntgenbild: ca. 2 MB - 10 MB)
Datensicherung:	Tägliche Datensicherung
Schnittstelle:	Ethernet ≥ 100 MBit/s
Grafikkarte:	Auflösung ≥ 1280 x 1024 Farbtiefe 32 Bit, 16,7 Millionen Farben

Vet-Exam plus

gültig ab Version 7

CPU:	≥ Intel Pentium IV kompatibel, 1,4 GHz
RAM:	≥ 1 GB (empfohlen 2 GB)
Betriebssysteme:	Microsoft Windows 10 (ab Pro) Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019
Festplatte:	Workstation (ohne Datenbank) ≥ 50 GB Der Speicherbedarf der Datenbank orientiert sich am Bildaufkommen in der Praxis. (Kamerabild: ca. 1 MB, Röntgenbild: ca. 2 MB - 10 MB)
Laufwerk:	DVD-ROM
Datensicherung:	Tägliche Datensicherung
Schnittstelle:	Ethernet ≥100 MBit/s
Grafikkarte:	Auflösung ≥ 1024 X 768 Farbtiefe 32 Bit, 16,7 Millionen Farben